



202319122302

水污染源在线监测系统 验收比对检测报告

报告编号:LM202506B0880

茂名市电白区污水溢流入海应急整治净化站

项目名称:

临建工程项目

委托单位:

广州市绿创环境科技有限公司

运行单位:

电白城区水质净化厂三期

检测类别:

委托检测

广东蓝梦检测有限公司





检测报告说明

- 1、本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。
- 2、本报告未加盖本公司“CMA 章”及“检验检测专用章”无效。
- 3、复制本报告未重新加盖本公司“CMA 章”、“检验检测专用章”无效，
报告部分复制无效。
- 4、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 5、本报告经涂改无效。
- 6、本公司只对来样或自采样品负责。
- 7、本报告未经本公司同意不得用于广告、商业宣传等行为。
- 8、对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，
逾期不申请的，视为认可检测报告。

机构通讯资料:

广东蓝梦检测有限公司

地址:阳江市阳东区升平路 91 号及阳江市江城区东风四路 18 号

商铺二楼

邮政编码:529900

电话:0662-6388999/6881999



1.检测概况

检测概况见表 1。

表 1 检测概况

委托单位		广州市绿创环境科技有限公司	
被检测单位		电白城区水质净化厂三期	
被检测单位地址		茂名市电白区水东街道罗屋	
采样及现场检测	人员	黄亚杰、李周真	
	日期	2025 年 06 月 06、07 日	
实验室分析	人员	项士铭、谢彩芳、谭荡记	
	日期	2025 年 06 月 07 日-2025 年 06 月 10 日	

2.检测项目

废水检测见表 2。

表 2 废水检测类型、检测点位名称、检测项目及检测频次

类型	检测点 位名称	检测项目	检测频次	
			标准样品	实际水样
废水	进水口	化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	2 种不同浓度，每种测量 3 次	每 1h 检测 1 个样品，检测 3 个样品，每个样品在线仪器平行测定 2 次
	出水口	pH 值	检测 6 次	每 1h 检测 1 个样品，检测 3 个样品，每个样品在线仪器平行测定 6 次
		化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	2 种不同浓度，每种测量 3 次	每 1h 检测 1 个样品，检测 3 个样品，每个样品在线仪器平行测定 2 次

3.检测方法与方法来源

检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器等见表 3。

表 3 检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及型号	仪器编号	检出限/测量范围	检测地址
pH 值	电极法	HJ 1147-2020	METER pH 计检测仪	LBJC/ZC-259	0-14 (无量纲)	东风四路 18 号
总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	L5S 紫外可见分光光度计	LBJC/ZC-034	0.01 mg/L	
总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	L5S 紫外可见分光光度计	LBJC/ZC-034	0.05 mg/L	
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	L5S 紫外可见分光光度计	LBJC/ZC-034	0.025 mg/L	
化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	50 mL 滴定管	/	4 mg/L	



4. 比对方法依据

- (1) 《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)
- (2) 《水污染源在线监测系统(COD_{Cr}、NH₃-N 等)验收技术规范》(HJ 354-2019)
- (3) 《水质 pH 值的测定 电极法》(HJ 1147-2020)
- (4) 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)
- (5) 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)
- (6) 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ 636-2012)
- (7) 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T 11893-1989)

5. 比对标准要求

表 4 水污染源在线监测仪器验收技术指标

项目	技术指标要求		试验指标限值	样品数量要求
pH 值	准确度	pH=4.008 (25℃) 的有证标准样品	±0.5	连续测定 6 次, 以 6 次在线仪器测定值的算术平均值
	实际水样比对		±0.5	测定实际废水样品 3 个, 每个水样在线仪器平行测定 6 次, 以 6 次在线仪器测定值的算术平均值计
总氮	准确度	有证标准溶液浓度 <2 mg/L	±0.3 mg/L	一种为接近实际废水排放浓度的样品, 另一种为接近相应排放标准浓度 2~3 倍的样品, 每种有证标准样品平行测定 3 次, 以 3 次仪器测定值的算术平均值计
		有证标准溶液浓度 ≥2 mg/L	±10%	
	实际水样比对	实际水样总氮 <2 mg/L (用浓度为 1.5 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试)	±0.3 mg/L	以 1 h 为周期, 测定实际废水样品 3 个, 每个水样在线仪器平行测定 2 次, 以 2 次在线仪器测定值的算术平均值计
		实际水样总氮 ≥2 mg/L	±15%	
化学需氧量	准确度	有证标准溶液浓度 <30mg/L	±5 mg/L	同总氮比对试验数量要求
		有证标准溶液浓度 ≥30mg/L	±10%	
	实际水样比对	实际水样 COD _{Cr} <30 mg/L (用浓度为 20~25 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试)	±5 mg/L	
		30 mg/L ≤ 实际水样 COD _{Cr} <60 mg/L	±30%	
		60 mg/L ≤ 实际水样 COD _{Cr} <100 mg/L	±20%	
		实际水样 COD _{Cr} ≥100 mg/L	±15%	
氨氮	准确度	有证标准溶液浓度 <2mg/L	±0.3 mg/L	同总氮比对试验数量要求
		有证标准溶液浓度 ≥2mg/L	±10%	
	实际水样比对	实际水样氨氮 <2 mg/L (用浓度为 1.5 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试)	±0.3 mg/L	
		实际水样氨氮 ≥2 mg/L	±15%	



项目	技术指标要求		试验指标限值	样品数量要求
总磷	准确度	有证标准溶液浓度 $<0.4\text{mg/L}$	$\pm 0.06\text{ mg/L}$	同总氮比对试验数量要求
		有证标准溶液浓度 $\geq 0.4\text{mg/L}$	$\pm 10\%$	
	实际水样比对	实际水样总磷 $<0.4\text{ mg/L}$ (用浓度为 0.3mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试)	$\pm 0.06\text{ mg/L}$	
		实际水样总磷 $\geq 0.4\text{ mg/L}$	$\pm 15\%$	

6. 比对结果见下表

在线监测系统比对检测结果见表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11、表 12、表 13。

表 5 总磷在线监测系统比对检测结果

检测点位名称		出水口				样品类型		废水	
自动仪器测量范围		0-1 mg/L				测试项目（单位）		总磷（mg/L）	
质控样代替实际水样测试									
标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	绝对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BW30078-1 000-20	B24110021	2025.06.06	15:01-15:59	0.221	0.218	0.2	0.018 mg/L	±0.06 mg/L	合格
			16:01-16:59	0.214					
			17:01-17:59	0.212	0.213	0.2	0.013 mg/L	±0.06 mg/L	合格
			18:01-18:59	0.214					
			19:01-19:59	0.209	0.210	0.2	0.010 mg/L	±0.06 mg/L	合格
			20:01-20:59	0.210					
准确度测试									
标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	相对误差/ 绝对误差	试验指标 限值	结果 评定
				测定值	平均值				
BW30078-1 000-20	B24110021	2025.06.06	10:42-11:23	0.904	0.910	1.0	-9.00 %	±10 %	合格
			11:24-12:00	0.911					
			12:01-12:38	0.915					
			12:39-13:15	0.221	0.217	0.2	0.017 mg/L	±0.06 mg/L	合格
			13:16-13:52	0.214					
			13:53-14:32	0.215					
技术说明									
	方法原理	仪器名称		仪器型号		仪器出厂编号		检出限	
试验仪器	钼酸铵分光光度法	紫外可见分光光度计		L5S		077117070717080007		0.01 mg/L	
自动仪器	钼酸盐分光光度法	总磷水质在线分析仪		TEM-TP9000		83002143		0.01 mg/L	
比对结果	实际水样测试合格，准确度测试合格，总体评定合格。								

表 6 氨氮在线监测系统比对检测结果

检测点位名称	出水口	样品类型	废水
自动仪器测量范围	0-10 mg/L	测试项目（单位）	氨氮（mg/L）

质控样代替实际水样测试

标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	绝对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BY400012	B24040515	2025.06.06	15:01-15:22	1.253	1.254	1.50	-0.246 mg/L	±0.3 mg/L	合格
			16:01-16:22	1.256					
			17:01-17:22	1.233	1.228	1.50	-0.272 mg/L	±0.3 mg/L	合格
			18:01-18:23	1.222					
			20:01-20:22	1.231	1.225	1.50	-0.275 mg/L	±0.3 mg/L	合格
			22:01-22:23	1.219					

准确度测试

标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	相对误差/绝对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BW20085-2 000-50	B24010234	2025.06.06	11:01-11:23	9.313	9.380	10.0	-6.20 %	±10 %	合格
			11:24-11:42	9.353					
			11:43-12:00	9.475					
BY400012	B24040515	2025.06.06	12:21-12:39	1.522	1.359	1.50	-0.141 mg/L	±0.3 mg/L	合格
			12:40-13:00	1.292					
			13:01-13:21	1.262					

技术说明

	方法原理	仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限
试验仪器	纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计	LSS	077117070717080007	0.025 mg/L
自动仪器	水杨酸分光光度法	氨氮水质在线监测仪	TEM-NH3N9000	82201834	0.02 mg/L
比对结果	实际水样测试合格，准确度测试合格，总体评定合格。				



表 7 pH 值在线监测系统比对检测结果

检测点位名称		出水口		样品类型		废水		
自动仪器测量范围		0-14（无量纲）		测试项目（单位）		pH 值（无量纲）		
实际水样比对测试								
样品编号	采样日期	采样时间	水质分析仪测定值		实验室测定值	绝对误差	试验指标限值	结果评定
			测定值	平均值				
J2025060880-1-1-001	2025.06.06	11:51	6.5109	6.6230	6.6	0.0230	±0.5	合格
			6.5793					
			6.6270					
			6.6574					
			6.6753					
			6.6882					
J2025060880-1-1-002		12:54	6.7031	6.7280	6.7	0.0280	±0.5	合格
			6.7110					
			6.7219					
			6.7337					
			6.7529					
			6.7456					
J2025060880-1-1-003		13:53	6.7491	6.7671	6.8	-0.0329	±0.5	合格
			6.7549					
			6.7665					
			6.7728					
			6.7795					
			6.7800					

准确度测试									
标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	测试结果		标准样品值	绝对误差	试验指标限值	结果评定
				测试结果	平均值				
BY400065	B24120023	2025.06.06	10:40-10:49	3.8410	3.8939	4.13	-0.2361	±0.5	合格
			10:50-10:59	3.8437					
			11:00-11:09	3.8527					
			11:10-11:19	4.0945					
			11:20-11:29	3.8743					
			11:30-11:39	3.8570					

技术说明					
	方法原理	仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限
试验仪器	电极法	pH 计检测仪	METER	24082893	0.01（无量纲）
自动仪器	玻璃电极法	pH 计	TPH10AC+TPH-SOC10	512504069	/
比对结果	实际水样测试合格，准确度测试合格，总体评定合格。				

表 8 化学需氧量在线监测系统比对检测结果

检测点位名称	出水口	样品类型	废水
自动仪器测量范围	0-100 mg/L	测试项目 (单位)	化学需氧量 (mg/L)

质控样代替实际水样测试

标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	绝对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BW20003-1 000-WS-50	B25020509	2025.06.06	15:01-15:59	26.704	26.682	25.0	1.682 mg/L	±5 mg/L	合格
			16:01-16:59	26.660					
			17:01-17:59	25.351	23.040	25.0	-1.960 mg/L	±5 mg/L	合格
			18:01-18:59	20.730					
			19:01-19:59	20.966	20.710	25.0	-4.290 mg/L	±5 mg/L	合格
			20:01-20:59	20.454					

准确度测试

标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	相对误差/ 绝对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BW20003-5 000-50	B25030114	2025.06.06	10:44-11:24	79.779	80.170	80.0	0.21 %	±10 %	合格
			11:25-12:04	79.556					
			12:05-12:45	81.176					
BW20003-1 000-WS-50	B25020509		12:46-13:28	26.083	26.372	25.0	1.372 mg/L	±5 mg/L	合格
			13:29-14:08	26.379					
			14:09-14:59	26.653					

技术说明

	方法原理	仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限
试验仪器	重铬酸盐法	50 mL 滴定管	/	/	4 mg/L
自动仪器	重铬酸钾分光光度法	CODer 在线监测仪	TEM-COD9000	81002873	10 mg/L
比对结果	实际水样测试合格, 准确度测试合格, 总体评定合格。				

表 9 总氮在线监测系统比对检测结果

检测点位名称	出水口					样品类型	废水		
自动仪器测量范围	0-30 mg/L					测试项目（单位）	总氮（mg/L）		
实际水样比对测试									
样品编号	采样日期	采样时间	水质分析仪测定		实验室测定		相对误差	试验指标限值	结果评定
			测定值	平均值	测定日期	测定值			
J2025060880-1-1-001	2025.06.06	11:51	10.799	10.797	2025.06.10	11.5	-6.11 %	±15 %	合格
10.795									
J2025060880-1-1-002		12:54	10.684	10.670		12.2	-12.54 %	±15 %	合格
10.657									
J2025060880-1-1-003		13:53	10.775	10.769		9.72	10.79 %	±15 %	合格
10.763									
准确度测试									
标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	相对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BW20008-1 000-W-50	B25020462	2025.06.06	11:46-12:36	27.620	27.887	30	-7.04 %	±10 %	合格
			12:37-13:31	27.964					
			13:32-14:22	28.076					
BW30078-1 000-20	B24110021		14:23-15:10	10.329	10.527	10	5.27 %	±10 %	合格
			15:11-15:58	10.533					
			15:59-16:49	10.719					
技术说明									
	方法原理	仪器名称		仪器型号		仪器出厂编号		检出限	
试验仪器	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	紫外可见分光光度计		L55		077117070717080007		0.05 mg/L	
自动仪器	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	总氮水质在线分析仪		TEM-TP9000		83701727		0.01 mg/L	
比对结果	实际水样测试合格，准确度测试合格，总体评定合格。								

表 10 化学需氧量在线监测系统比对检测结果

检测点位名称		进水口			样品类型		废水		
自动仪器测量范围		0-600 mg/L			测试项目（单位）		化学需氧量（mg/L）		
实际水样比对测试									
样品编号	采样日期	采样时间	水质分析仪测定		实验室测定		相对误差	试验指标限值	结果评定
			测定值	平均值	测定日期	测定值			
J2025060880-1-2-001	2025.06.06	12:50	119.102	116.617	2025.06.10	120	-2.82 %	±15 %	合格
114.132									
J2025060880-1-2-002		13:50	113.157	110.992		112	-0.90 %	±15 %	合格
108.827									
J2025060880-1-2-003		14:52	108.044	107.308		105	2.20 %	±15 %	合格
106.572									
准确度测试									
标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	相对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BW20003-5000-50	B25030114	2025.06.06	10:30-11:09	503.222	501.839	500	0.37 %	±10 %	合格
			11:10-11:47	499.694					
			11:48-12:28	502.602					
BW20003-1000-WS-50	B25020509		12:29-13:09	152.231	150.430	150	0.29 %	±10 %	合格
			13:10-13:46	150.596					
			13:47-14:26	148.463					
技术说明									
	方法原理	仪器名称		仪器型号		仪器出厂编号		检出限	
试验仪器	重铬酸盐法	50 mL 滴定管		/		/		4 mg/L	
自动仪器	重铬酸钾分光光度法	CODer 在线监测仪		TEM-COD9000		81004063		10 mg/L	
比对结果	实际水样测试合格，准确度测试合格，总体评定合格。								

表 11 氨氮在线监测系统比对检测结果

检测点位名称		进水口			样品类型		废水		
自动仪器测量范围		0-50 mg/L			测试项目（单位）		氨氮（mg/L）		
实际水样比对测试									
样品编号	采样日期	采样时间	水质分析仪测定		实验室测定		相对误差	试验指标限值	结果评定
			测定值	平均值	测定日期	测定值			
J2025060880-1-2-001	2025.06.06	12:50	26.602	26.310	2025.06.10	25.8	1.98 %	±15 %	合格
26.017									
J2025060880-1-2-002		13:50	26.182	26.290		25.9	1.51 %	±15 %	合格
26.397									
J2025060880-1-2-003		14:52	26.170	26.203		25.4	3.16 %	±15 %	合格
26.236									
准确度测试									
标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	相对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BW20085-2 000-50	B24010234	2025.06.06	10:00-10:18	49.325	49.569	50	-0.86 %	±10 %	合格
			10:19-10:40	49.609					
			10:41-11:01	49.772					
			11:02-11:23	25.539	25.733	25.0	2.93 %	±10 %	合格
			11:24-11:43	25.857					
			11:44-12:03	25.802					
技术说明									
	方法原理	仪器名称		仪器型号		仪器出厂编号		检出限	
试验仪器	纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计		L5S		077117070717080007		0.025 mg/L	
自动仪器	水杨酸分光光度法	氨氮水质在线监测仪		TEM-NH3N9000		82202603		0.02 mg/L	
比对结果	实际水样测试合格，准确度测试合格，总体评定合格。								

表 12 总磷在线监测系统比对检测结果

检测点位名称		进水口			样品类型		废水			
自动仪器测量范围		0-10 mg/L			测试项目（单位）		总磷（mg/L）			
实际水样比对测试										
样品编号	采样日期	采样时间	水质分析仪测定		实验室测定		相对误差	试验指标限值	结果评定	
			测定值	平均值	测定日期	测定值				
J2025060880-1-2-001	2025.06.06	12:50	2.558	2.606	2025.06.07	2.76	-5.58%	±15%	合格	
2.655										
J2025060880-1-2-002		13:50	2.646	2.634		2.98	-11.61%	±15%	合格	
2.623										
J2025060880-1-2-003		14:52	2.615	2.608		2.34	11.45%	±15%	合格	
2.601										
准确度测试										
标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	相对误差	试验指标限值	结果评定	
				测定值	平均值					
BW30078-5 00-500	B23090257	2025.06.06	10:01-10:37	10.309	10.236	10.0	2.36%	±10%	合格	
			10:38-11:16	10.273						
			11:17-11:58	10.126						
			11:59-12:47	2.171	2.069	2.0	3.45%	±10%	合格	
			12:48-13:24	2.028						
			13:25-13:59	2.008						
技术说明										
	方法原理		仪器名称		仪器型号		仪器出厂编号		检出限	
试验仪器	钼酸铵分光光度法		紫外可见分光光度计		L5S		077117070717080007		0.01 mg/L	
自动仪器	钼酸盐分光光度法		总磷水质在线分析仪		TEM-TP9000		83002777		0.01 mg/L	
比对结果	实际水样测试合格，准确度测试合格，总体评定合格。									

表 13 总氮在线监测系统比对检测结果

检测点位名称		进水口			样品类型		废水		
自动仪器测量范围		0-80 mg/L			测试项目（单位）		总氮（mg/L）		
实际水样比对测试									
样品编号	采样日期	采样时间	水质分析仪测定		实验室测定		相对误差	试验指标限值	结果评定
			测定值	平均值	测定日期	测定值			
J2025060880-1-2-001	2025.06.06	12:50	27.434	27.592	2025.06.10	26.2	5.31%	±15 %	合格
			27.751						
13:50		27.259	27.756	29.0		-4.29 %	±15 %	合格	
		28.254							
J2025060880-1-2-002		14:52	27.564	27.581		32.0	-13.81 %	±15 %	合格
J2025060880-1-2-003			27.598						
准确度测试									
标准样品编号	标准样品批号	测试日期	测试时间	水质分析仪测定		标准样品值	相对误差	试验指标限值	结果评定
				测定值	平均值				
BW20008-1 000-W-50	B25020462	2025.06.06	11:33-12:22	80.787	79.938	80.0	-0.08 %	±10 %	合格
			12:23-13:10	78.984					
			13:11-14:04	80.043					
			14:48-15:40	28.127	28.120	30.0	-6.27 %	±10 %	合格
			15:41-16:27	27.896					
			16:28-17:19	28.338					
技术说明									
	方法原理		仪器名称		仪器型号		仪器出厂编号		检出限
试验仪器	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法		紫外可见分光光度计		L55		077117070717080007		0.05 mg/L
自动仪器	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法		总氮水质在线分析仪		TEM-TN9000		83702255		0.01 mg/L
比对结果	实际水样测试合格，准确度测试合格，总体评定合格。								

7、结论

进水口中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮和出水口中 pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮检测数据比对结果符合《水污染源在线监测系统 (COD_{Cr}、NH₃-N 等) 验收技术规范》(HJ 354-2019) 中指标限值要求。

报告结束

编制:

审核:

签发:

签发日期: 2025 年 6 月 19 日



附件一：质量保证和质量控制


1、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

质控数据分析表如下：

表1 水样质控数据分析表

检测项目	质控样浓度	质控样测定结果	平行样测定		加标回收率 (%)	现场空白
			测定结果	相对标准偏差 (%)		
总磷 (mg/L)	5.03±0.25	5.17	2.30	2.37	1.5	/

附件二：影像资料

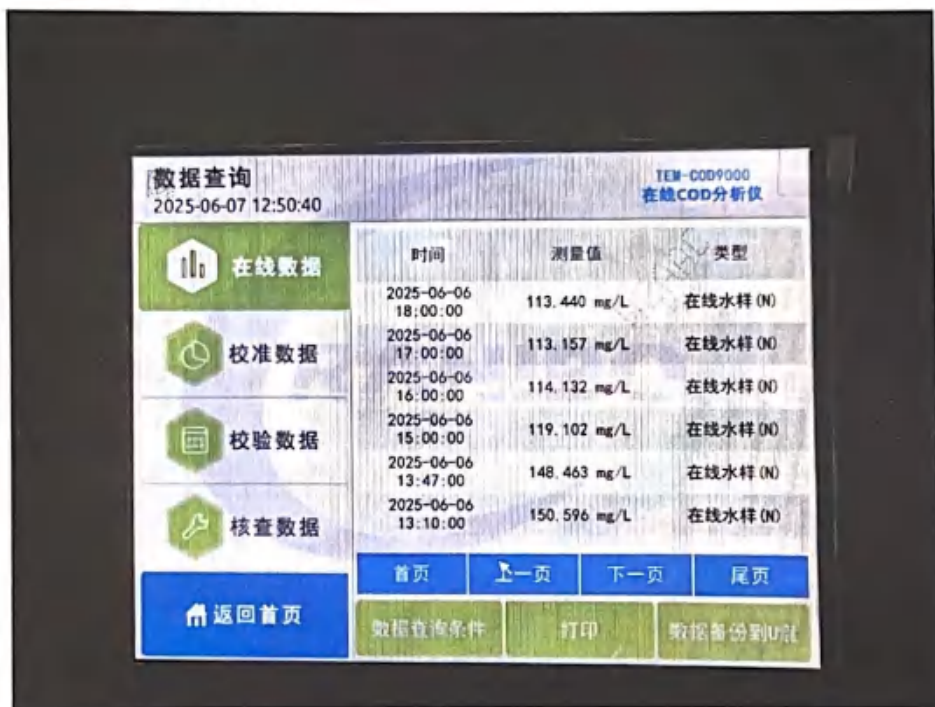



数据查询

2025-06-07 12:44:46

TEM-COD9000
在线COD分析仪

在线数据

时间

测量值

类型

2025-06-06 14:09:42	26.653 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 13:29:05	26.379 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 12:46:47	26.083 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 12:05:53	81.176 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 11:25:22	79.556 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 10:44:34	79.779 mg/L	在线水样 (N)



校准数据



校验数据



核查数据

返回首页

首页

上一页

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

数据查询

2025-06-07 12:50:46

TEM-COD9000
在线COD分析仪

在线数据

时间

测量值

类型

2025-06-07 00:00:00	102.057 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 23:00:00	103.138 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 22:00:00	105.279 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 21:00:00	106.572 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 20:00:00	108.044 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 19:00:00	108.827 mg/L	在线水样 (N)



校准数据



校验数据



核查数据

返回首页

首页

上一页

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘



数据查询

2025-06-07 12:51:21

TEM-NH3N9000
在线氨氮分析仪



在线数据

时间

测量值

类型

2025-06-06 18:00:00	26.236 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 17:00:00	26.170 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 16:00:00	26.397 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 15:00:00	26.182 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 14:00:00	26.017 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 13:00:00	26.602 mg/L	在线水样 (N)

首页

上一页

下一页

尾页

返回首页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

数据查询

2025-06-07 12:51:15

TEM-NH3N9000
在线氨氮分析仪



在线数据

时间

测量值

类型

2025-06-06 10:00:00	49.325 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 08:09:00	29.182 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 06:09:00	28.885 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 04:09:00	29.604 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 02:09:00	29.446 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 00:09:00	29.075 mg/L	在线水样 (N)

首页

上一页

下一页


尾页


返回首页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

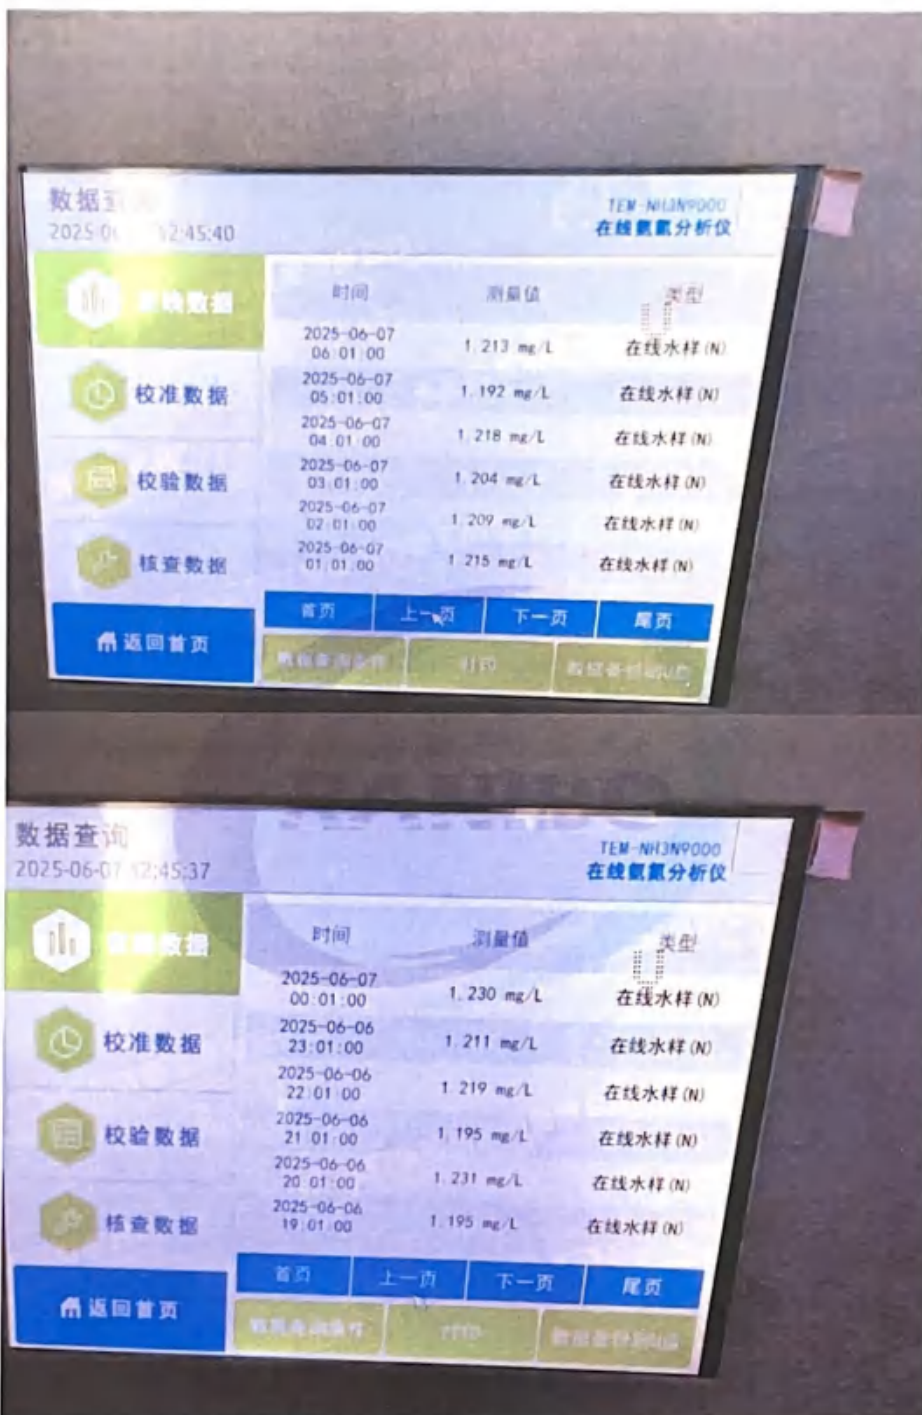

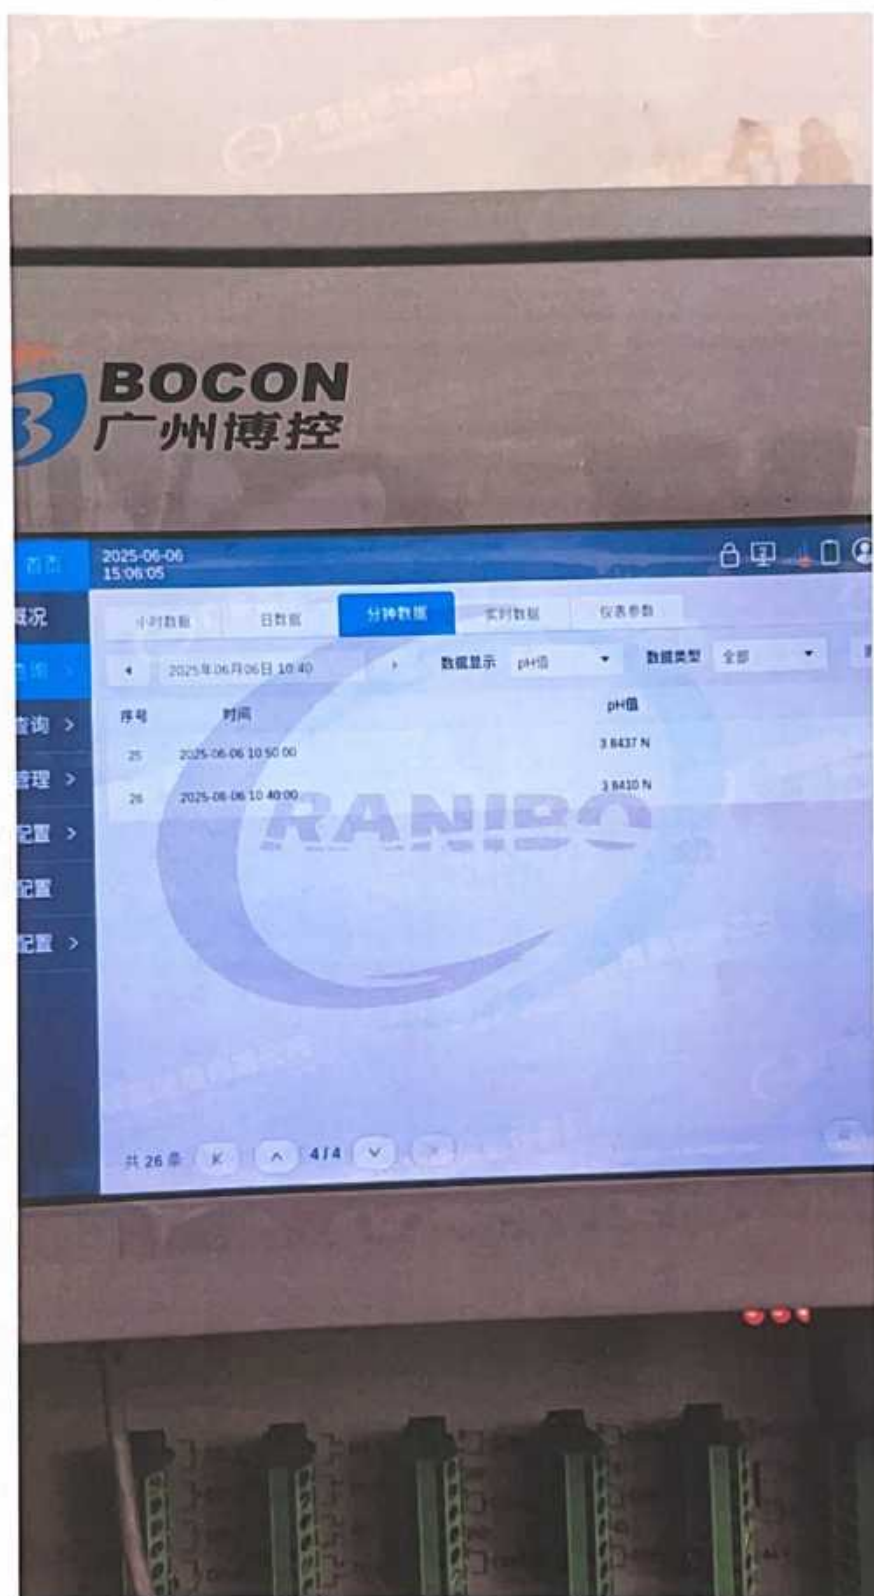







数据查询

2025-06-07 12:50:37

TEM-COD9000
在线COD分析仪



在线数据



校准数据



校验数据



核查数据

返回首页

时间

测量值

类型

2025-06-06 12:29:00	152.231 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 11:48:00	502.602 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 11:10:00	499.694 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 10:30:00	503.222 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 08:09:00	97.989 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 06:09:00	95.552 mg/L	在线水样(N)

首页

上一页

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

数据查询

2025-06-07 12:45:32

TEM-NH3N9000
在线氨氮分析仪



在线数据



校准数据



校验数据



核查数据

返回首页

时间

测量值

类型

2025-06-06 12:40:00	1.292 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 12:21:00	1.522 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 12:01:00	9.476 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 11:43:00	9.475 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 11:24:00	9.353 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 11:01:00	9.312 mg/L	在线水样(N)

首页

上一页

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘



数据查询

2025-06-07 12:45:34

TEM-NH3N9000
在线氨氮分析仪



在线数据



校准数据



校验数据



核查数据

时间	测量值	类型
2025-06-06 18:01:00	1.222 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 17:01:00	1.233 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 16:01:00	1.256 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 15:01:00	1.253 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 14:01:00	1.190 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 13:01:00	1.262 mg/L	在线水样 (N)

首页 上一页 下一页 尾页

返回首页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

数据查询

2025-06-07 12:44:40

TEM-TP9000
在线总磷分析仪



在线数据



校准数据



校验数据



核查数据

时间	测量值	类型
2025-06-06 18:01:00	0.214 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 17:01:00	0.212 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 16:01:00	0.214 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 15:01:00	0.221 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 13:53:00	0.215 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 13:16:00	0.214 mg/L	在线水样 (N)

首页 上一页 下一页 尾页

返回首页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘



数据查询		TEM-COD9000 在线COD分析仪	
2025-06-02 17:44:49			
时间	测量值	类型	
2025-06-06 20:01:33	20.454 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 19:01:33	20.966 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 18:01:34	20.730 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 17:01:33	25.351 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 16:01:34	26.660 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 15:01:33	26.704 mg/L	在线水样(N)	
首页		上一页	下一页
尾页			
返回首页		数据查询条件	打印
		数据备份到U盘	

数据查询		TEM-TP9000 在线总磷分析仪	
2025-06-07 12:53:02			
时间	测量值	类型	
2025-06-06 18:00:00	2.615 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 17:00:00	2.623 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 16:00:00	2.646 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 15:00:00	2.655 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 14:00:00	2.558 mg/L	在线水样(N)	
2025-06-06 13:25:00	2.008 mg/L	在线水样(N)	
首页		上一页	下一页
尾页			
返回首页		数据查询条件	打印
		数据备份到U盘	



数据查询

2025-06-07 17:44:37

TEM-TP9000

在线总磷分析仪



在线数据



校准数据



校验数据



核查数据

返回首页

时间

测量值

类型

2025-06-06 12:39:00	0.221 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 12:01:00	0.915 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 11:24:00	0.911 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 10:42:00	0.904 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 10:02:00	0.888 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 08:01:00	0.370 mg/L	在线水样 (N)

首页

上一页

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

数据查询

2025-06-07 12:51:18

TEM-MH3N9000

在线氨氮分析仪



在线数据



校准数据



校验数据



核查数据

返回首页

时间

测量值

类型

2025-06-06 12:04:00	25.937 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 11:44:00	25.802 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 11:24:00	25.857 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 11:02:00	25.539 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 10:41:00	49.772 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 10:19:00	49.609 mg/L	在线水样 (N)

首页

上一页

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘



数据查询

2025-06-07 12:49:17

TEM-TN9000
在线总氮分析仪

在线数据



校准数据



校验数据



核查数据

返回首页

时间	测量值	类型
2025-06-07 12:01:00	10.733 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-07 11:01:00	10.563 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-07 10:01:00	10.921 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-07 09:01:00	10.985 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-07 08:01:00	10.777 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-07 07:01:00	10.935 mg/L	在线水样 (N)

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

数据查询

2025-06-07 12:53:31

TEM-TN9000
在线总氮分析仪

在线数据



校准数据



校验数据



核查数据

返回首页

时间	测量值	类型
2025-06-06 11:33:00	80.787 mg/L	在线水样 (T)
2025-06-06 10:45:00	71.549 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 09:59:00	73.247 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 06:07:00	28.281 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 04:07:00	29.161 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 02:07:00	36.000 mg/L	在线水样 (N)

首页

上一页


下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

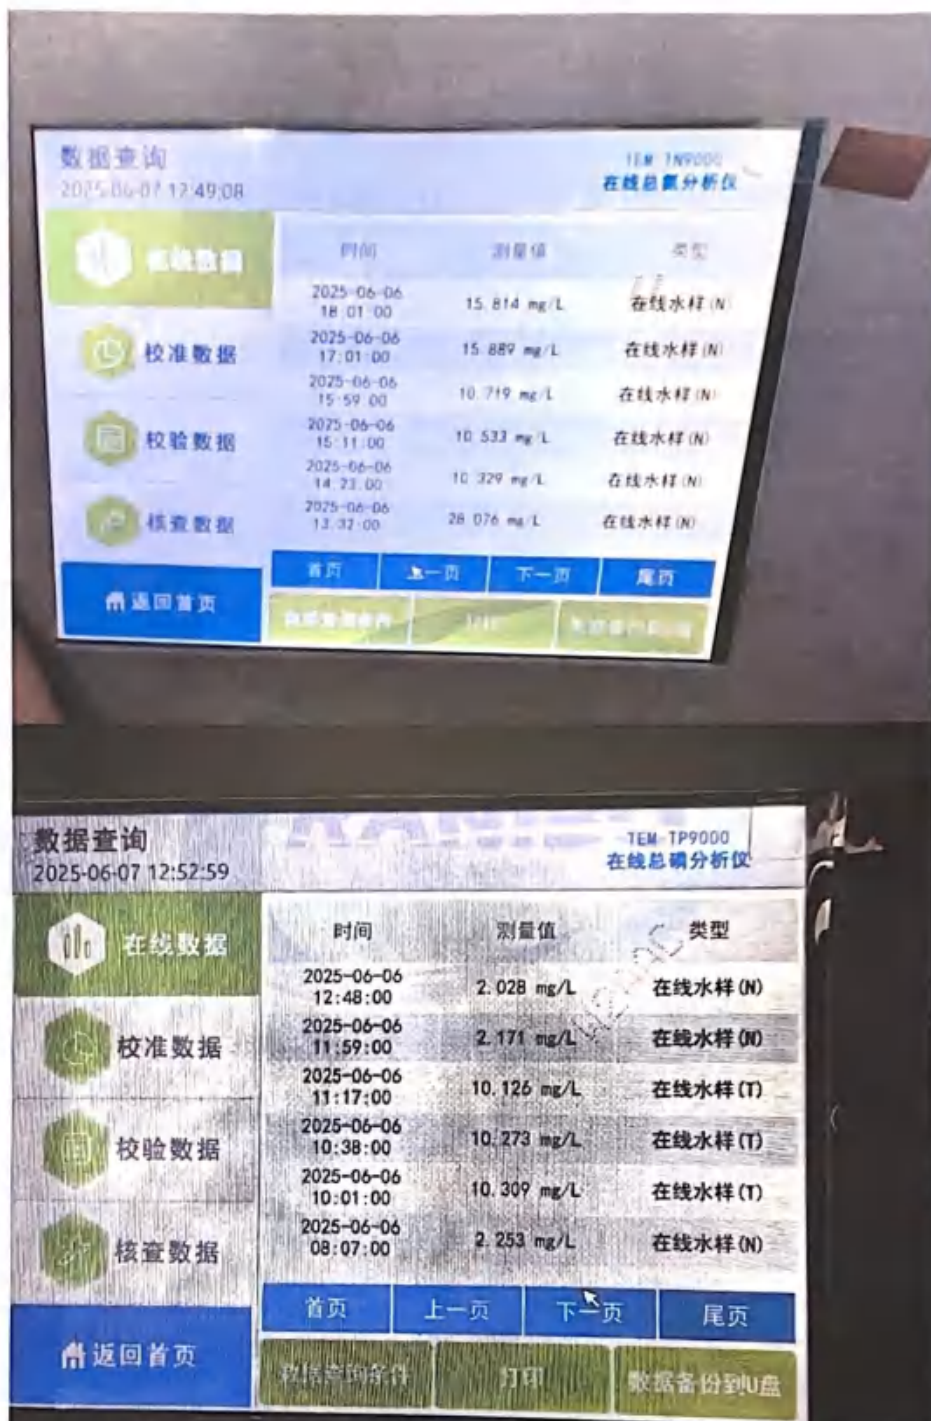



数据查询

2025-06-07 12:49:04

TEM-TN9000
在线总氮分析仪

在线数据

校准数据

校验数据

核查数据

返回首页

时间

测量值

类型

2025-06-06 12:37:00	27.964 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 11:46:00	27.620 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 10:55:00	26.267 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 10:05:00	25.541 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 08:01:00	14.882 mg/L	在线水样(N)
2025-06-06 06:01:00	10.994 mg/L	在线水样(N)

首页

上一页

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

数据查询

2025-06-07 12:49:13

TEM-TN9000
在线总氮分析仪

在线数据

校准数据

校验数据

核查数据

返回首页

时间

测量值

类型

2025-06-07 06:01:00	10.763 mg/L	在线水样(N)
2025-06-07 05:01:00	10.775 mg/L	在线水样(N)
2025-06-07 04:01:00	10.657 mg/L	在线水样(N)
2025-06-07 03:01:00	10.684 mg/L	在线水样(N)
2025-06-07 02:01:00	10.795 mg/L	在线水样(N)
2025-06-07 01:01:00	10.799 mg/L	在线水样(N)

首页

上一页

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘



数据查询

2025-06-07 12:53:04

TEM-TN9000
在线总氮分析仪



在线数据

时间

测量值

类型

2025-06-07 00:00:00	2.565 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 23:00:00	2.574 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 22:00:00	2.598 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 21:00:00	2.575 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 20:00:00	2.587 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 19:00:00	2.601 mg/L	在线水样 (N)



校准数据



校验数据



核查数据

首页

上一页

下一页

尾页

返回首页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

数据查询

2025-06-07 12:53:34

TEM-TN9000
在线总氮分析仪



在线数据

时间

测量值

类型

2025-06-06 18:00:00	27.434 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 16:28:00	28.338 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 15:41:00	27.896 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 14:48:00	28.127 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 13:11:00	80.043 mg/L	在线水样 (T)
2025-06-06 12:23:00	78.984 mg/L	在线水样 (N)



校准数据



校验数据



核查数据

首页

上一页

下一页

尾页

返回首页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘





数据查询

2025-06-07 12:44:43

TEM-TP9000
在线总磷分析仪



在线数据



校准数据



校验数据



核查数据

返回首页

时间

测量值

类型

2025-06-07 00:01:00	0.215 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 23:01:00	0.213 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 22:01:00	0.215 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 21:01:00	0.203 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 20:01:00	0.210 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 19:01:00	0.209 mg/L	在线水样 (N)

首页

上一页

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘

数据查询

2025-06-07 12:53:37

RANIBO

TEM-TN9000
在线总氮分析仪



在线数据



校准数据



校验数据



核查数据

返回首页

时间

测量值

类型

2025-06-07 00:00:00	27.321 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 23:00:00	27.598 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 22:00:00	27.564 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 21:00:00	28.254 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 20:00:00	27.259 mg/L	在线水样 (N)
2025-06-06 19:00:00	27.751 mg/L	在线水样 (N)

首页

上一页

下一页

尾页

数据查询条件

打印

数据备份到U盘



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 202319122302

名称: 广东蓝梦检测有限公司

地址: 阳江市阳东区东城镇升平路 91 号四楼

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。
资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由广东蓝梦检测有限公司承担。

许可使用标志



202319122302

注: 需要延续证书有效期的, 应当在
证书届满有效期 3 个月前提出申请,
不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

发证日期: 2023 年 12 月 22 日

有效期至: 2029 年 12 月 21 日

发证机关: (印章)

复查